

S.S. Ingegneria Clinica – Corso Svizzera, 164
10149 Torino

Procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 diagnostica telecomandata DR, destinata alla Casa della Comunità sita in Largo Cigna ex Astanteria Martini dell'ASL Città di Torino. Importo complessivo stimato della fornitura pari ad euro 170.000,00 oneri fiscali esclusi.
CUP F19I25001610001 e CIG BA9C0E987D

Verbale 2° seduta della Commissione Giudicatrice del 08/05/2026

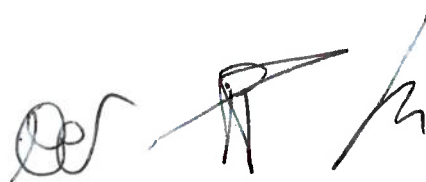

Il giorno 08/05/2026, alle ore 14.00, presso una stanza della S.S. Ingegneria Clinica, sita in corso Svizzera 164, Torino, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di n. 1 diagnostica telecomandata DR, destinata alla Casa della Comunità sita in Largo Cigna ex Astanteria Martini dell'ASL Città di Torino.

La commissione, nominata con Deliberazione n. 609/01.03/2026 del 21/04/2026, è così composta:

- Presidente:
 - o Dott. Roberto PLACIDO, Direttore S.C. Radiologia 3 P.O. Martini
- Componenti:
 - o Dott.ssa Claudia CUTAIA, Dirigente Fisico della S.C. Interaziendale Fisica Sanitaria A.O. Mauriziano di Torino ASL Città di Torino – ASL TO 3
 - o P.I. Stefano GRANELLA, Collaboratore Tecnico Professionale S.S. Ingegneria Clinica

La Commissione Giudicatrice riceve la documentazione tecnica necessaria alla valutazione e attribuzione dei punteggi qualitativi, secondo quanto previsto dalla Lettera di invito.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame delle offerte tecniche presentate, di seguito si riportano le risultanze dell'analisi della documentazione presentata dalle ditte e relativa valutazione.

I giudizi qualitativi, sulla base degli elementi di valutazione definiti nella Lettera di invito, sono sotto riportati per completezza espositiva.

Criteri di valutazione	Punti	Tipo
1. Caratteristiche migliorative del Tavolo telecomandato, rispetto alle minime richieste	12	D
2. Caratteristiche migliorative del Generatore alta tensione, rispetto alle minime richieste	4	D
3. Caratteristiche migliorative del Complesso radiogeno, rispetto alle minime richieste	4	D
4. Caratteristiche migliorative del Detettore DR, rispetto alle minime richieste	4	D
5. Caratteristiche migliorative della Consolle di comando, rispetto alle minime richieste	8	D
6. Caratteristiche migliorative del Monitor ripetitore, rispetto alle minime richieste	2	D
7. Caratteristiche migliorative degli Applicativi SW, rispetto alle minime richieste	8	D
8. Caratteristiche migliorative dei lavori preparatori all'installazione, rispetto alle minime richieste	6	D
9. Caratteristiche migliorative della durata e delle condizioni di garanzia, rispetto alle minime richieste	8	D
10. Qualità e quantità delle opzioni extra-offerta disponibili	4	D
TOTALE	60	

Motivazioni sintetiche della valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice per operatore economico:

1 – Caratteristiche migliorative del Tavolo telecomandato, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Tavolo	Altezza var	Escursione long e trasv	Ribaltamento	Portata dinam	Portata statica	Distanza focale
GMM	240x80	50-100 cm	160 cm, 35 cm	± 90°	266 Kg	323 Kg	180 cm
SIEMENS	210x80	48-98 cm	160 cm, 35 cm	± 90°	300 Kg	350 Kg	150 cm
VILLA	247x80	40-124 cm	160 cm, 36 cm	± 90°	300 Kg	n/d	200 cm

GMM: caratteristiche tecniche del tavolo telecomandato migliorative con particolare riferimento alla centratura del paziente (10)

SIEMENS: dimensioni del tavolo e distanza focale inferiori a quanto richiesto nelle caratteristiche minime; le restanti caratteristiche sono migliorative rispetto al richiesto (8)

VILLA: caratteristiche tecniche del tavolo telecomandato migliorative rispetto alle minime richieste, superiori alle altre due ditte offerenti (12)

2 – Caratteristiche migliorative del Generatore alta tensione, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Potenza generatore alta tensione	Punti
GMM	80 kW	0
SIEMENS	80 KW	0
VILLA	100 KW	4

3 – Caratteristiche migliorative del Complesso radiogeno, rispetto alle minime richieste:

Tutte le ditte presentano una o più caratteristiche migliorative, diverse tra loro, di potenziale interesse (4)

4 – Caratteristiche migliorative del Detettore DR, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Formato	Conversione	Pixel	Risoluzione spaziale	Punti
GMM	43x43	16 bit	139 µm	3,6	2
SIEMENS	43x43	16 bit	148 µm	3,4	0
VILLA	43x43	16 bit	139 µm	n/d	2

5 – Caratteristiche migliorative della Consolle di comando, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Processore	RAM	HD	Punti
GMM	Intel Core i9	16 GB	2 Tb	8
SIEMENS	Intel Core i3	8 GB	2 Tb	2
VILLA	Intel Core Ultra 5	16 GB	1 Tb	6

6 – Caratteristiche migliorative del Monitor ripetitore, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Dimensioni	Risoluzione	Punti
GMM	23"	1920x1080	2
SIEMENS	19"	1280x1024	1
VILLA	24"	n/d	2

7 – Caratteristiche migliorative degli Applicativi SW, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Applicativi SW	Punti
GMM	DICOM, Stitching, Tomosintesi, Dual Energy, Boost Liner (miglioramento visione cateteri)	4
SIEMENS	DICOM, Stitching	0
VILLA	DICOM, Stitching, Tomosintesi, Dual Energy	2

8 – Caratteristiche migliorative dei lavori preparatori all'installazione, rispetto alle minime richieste:

Tutti gli operatori: nessuna miglioria evidenziata, l'installazione procederà come richiesto in quanto il locale è già idoneo all'installazione dell'apparecchiatura (0)

9 – Caratteristiche migliorative della durata e delle condizioni di garanzia, rispetto alle minime richieste:

Ditta	Garanzia	Punti
GMM	+16 mesi	8
SIEMENS	+3 mesi	1,5
VILLA	+12 mesi	6

10 – Qualità e quantità delle opzioni extra-offerta disponibili

GMM: Sistemi di intelligenza artificiale Galileo, possibilità di installazione stativo pensile con tavolo mobile, software per angiografia DSA (3)

SIEMENS: non si evidenziano opzioni extra-offerta significative (0)

VILLA: software per angiografia DSA (2)



La sintesi dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice è la seguente:


ELEMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOT
PUNTI MAX	12	4	4	4	8	2	8	6	8	4	60
GMM	10	0	4	2	8	2	4	0	8	3	41
SIEMENS	8	0	4	0	2	1	0	0	1,5	0	16,5
VILLA	12	4	4	2	6	2	2	0	6	2	40

Non essendoci null'altro da verbalizzare, il presente verbale viene chiuso alle ore 16.00 del giorno 08/05/2026.


Il presente verbale è composto di 5 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto,

Dott. Roberto PLACIDO
Direttore S.C. Radiologia 1 P.O. Martini

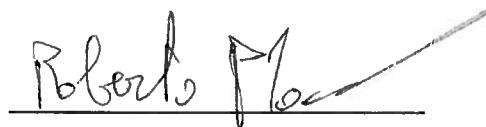

Dott.ssa Claudia CUTAIA
Dirigente Fisico della S.C. Interaziendale Fisica Sanitaria
A.O. Mauriziano di Torino ASL Città di Torino – ASL TO 3



Stefano GRANELLA
Collaboratore Tecnico Professionale S.S. Ingegneria Clinica

